


DISPENSADOR-AUTOMATICO

DISPENSADOR AUTOMÁTICO PARA LÍQUIDO SANITIZANTE

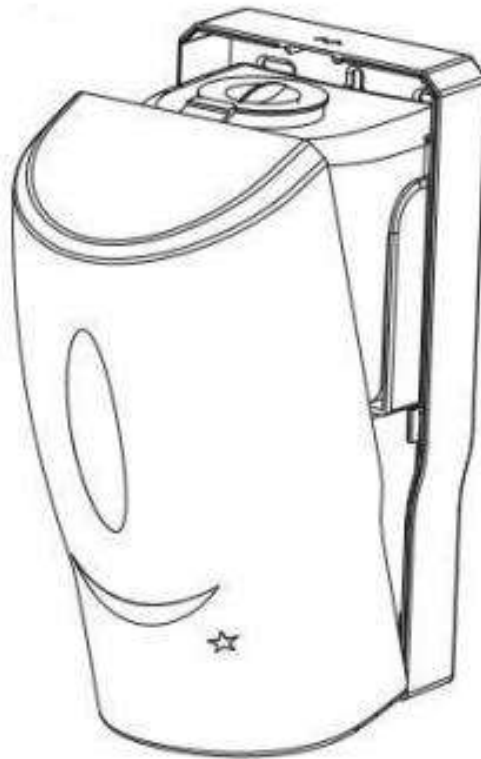

Descripción:

Dispensador automático para líquido sanitizante


- Fácil instalación y operación.
- Sanitización automática libre de contacto mediante sensor.
- Dosifica aproximadamente 0.3mL de líquido sanitizante.
- Detección a 12cm de distancia.
- Ideal para jabón líquido, alcohol diluido y sustancias sanitizantes líquidas.

****Favor de leer y seguir detenidamente las recomendaciones e instrucciones indicadas en la sección de Diagrama de instalación.**

Especificaciones del producto:


Nombre del producto	Dispensador automático para líquido sanitizante
Modelo	DISPENSADOR-AUTOMATICO
Características eléctricas de entrada	6VCD 1.5A (Se incluye fuente)
Características de baterías	4 x 1.5V (AA) (No se incluyen baterías)
Color de la carcasa	Blanca
Dimensión del producto	260x123x130mm
Capacidad	1L
Tiempos de duración de dosificación	0.8s y 1.2s

Dimensiones del producto:

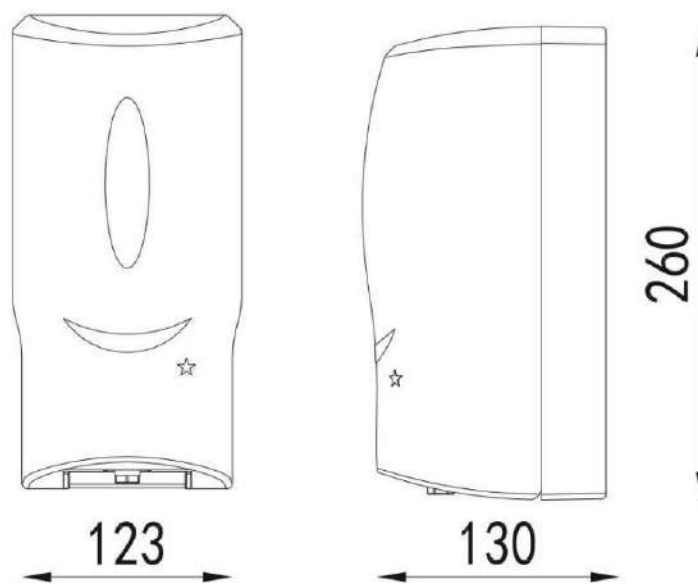


(Dimensiones en mm)


Diagrama de instalación:

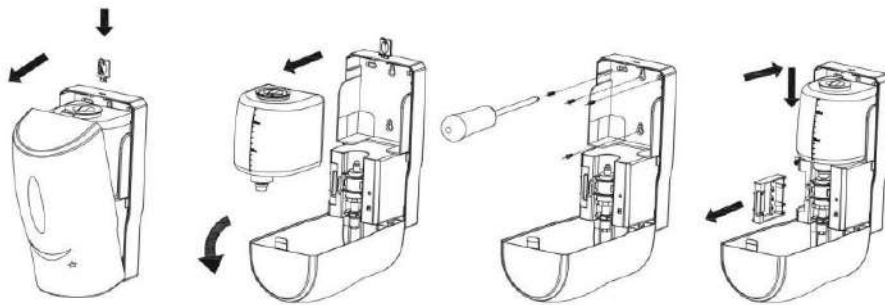

1. Insertar la llave en el agujero localizado en la parte superior del dispensador para poder bajar la carcasa delantera.
2. Bajar el tanque contenedor del líquido sanitizante teniendo cuidado de no lastimar la unión del tanque y la parte metálica de unión con la manguera.
3. Fijar el dispensador sobre una superficie plana.
4. Regresar el tanque a su posición y retirar el compartimiento para las baterías.

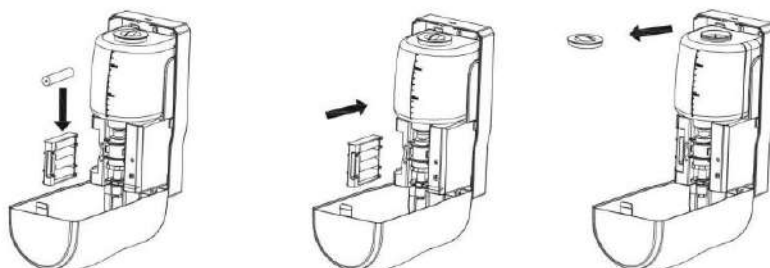

5. Colocar las baterías en el compartimiento, respetando la polaridad indicada.
6. Volver a colocar el compartimiento con las baterías en el espacio indicado.
7. Abrir la tapa del tanque contenedor de líquido, situado en la parte superior de este.

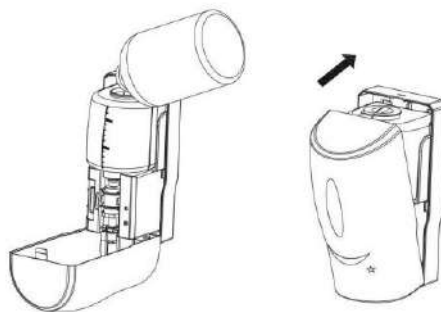

8. Verter el líquido destinado para la desinfección, evitando una sobrecarga y derrames de este **(se recomienda hacer uso de un embudo al vaciar el líquido en el tanque del dispensador)**.

En caso de existir derrames en la electrónica interna la garantía no será válida.

9. Mover el interruptor al tiempo deseado de dosificación.
10. Cerrar la tapa de la carcasa.

****Nota:** Durante la instalación no tuerza ni fuerce la boquilla del contenedor con el conector metálico que lo une a la manguera, con el fin de mantener en buen estado y no dañar el dispositivo.

*****Se recomienda el uso de SANIVIR-1L o SANIVIR-5L. De venta en <http://www.agelectronica.com>.**

La garantía de este producto es por 90 días a partir de la compra, por defectos de fábrica.

SANITIZACION

Campo de aplicaciones

- > Protocolo de limpieza de manos
- > Higiene personal
- > Hospitales, consultorios, escuelas
- > Ingreso a áreas con alto control sanitario
- > Manejo de alimentos
- > Superficies solidas de contacto humano
- > Objetos de uso diario (celulares, teclados, perillas, etc.)

Características Adicionales

- > Humectante
- > Aplicación directa
- > No requiere enjuague
- > La frecuencia de uso no reseca
- > Multifuncional
- > Presentaciones: Garrafa de 5 Litros / Ecopack: 20 Litros (4x5 Lt) / Pallet: 36 cajas (720 litros) Tótem: 1000 Litros

Especificaciones

SANITIZANTE GERMICIDA

Clave Kemix: SVA
 Peso específico: 1.01 g / ml
 Color: Azul transparente
 Olor: Característico
 Estado: Líquido
 Solubilidad: No aplica
 pH al 1%: Neutro
 Estabilidad: 2 años

SANITIZANTE GERMICIDA PARA MANOS Y CUERPO - SANIVIR

Sanivir es un producto sanitizante de uso directo con muy amplio espectro y de sales cuaternarias de 5G (DIDECYL DIMETHYL AMMONIUM CHLORIDE, BENZALKONIUM CHLORIDE).

Especialmente diseñado para limpiar y desinfectar, adecuado para la limpieza protocolaria de manos y cuerpo. Su grado sanitario lo hace ideal donde se requiera asegurar la inocuidad, ofreciendo un alto nivel de protección que elimina hasta 99.9% de los gérmenes dentro de los 30 segundos posteriores a su aplicación.

Altamente efectivo contra virus como el CORONAVIRUS, VIH, INFLUENZA (H1N1), HEPATITIS y demás.

SVA seca rápidamente al aire de forma natural sin dejar rastros de líquido o residuos pegajosos, no se necesita enjuagar; cuenta con propiedades humectantes, emolientes y pH balanceado

El SVA es **MULTIFUNCIONAL** debido a que también funciona en superficies solidas de frecuente contacto humano como son celulares, teclados, perillas, utensilio, herramientas de trabajo, etc.).

USO:

Este producto puede ser utilizado con un aplicador atomizador o un aplicador de espuma (individuales/personales o de pared).

Manos y cuerpo: Aplique cantidad suficiente y frotar hasta su total absorción.

Superficies o equipos: Aplique una cantidad generosa y retire el exceso con un paño o servilleta.

Ropa/tela/Vestimenta: aplicar una cantidad considerables con atomizador sobre la ropa (atomizado o nebulizado)

Cumple con las siguientes Normas Internacionales de Sanitización y Desinfección:

FDA (USA) 21CFR333.470
DIN (Alemania y UE) EN 1500
 PrEN 12054
 EN 11276
 EN 13704

	0	Salud/ Health
	0	Inflamabilidad/ Flammability
	0	Reactividad/ Reactivity
	N/A	Equipo Protector/ Protective Equipment

NFPA

Información de seguridad

- > Evite contacto con los ojos.
- > No ingerir.
- > No se deje al alcance de los niños.

PRECAUCIONES:

- > En caso de contacto con los ojos si tiene lentes de contacto retírelos y lave de inmediato con agua corriente por al menos 15 minutos, manteniendo los parpados abiertos.
- > En caso de ingestión, enjuague la boca con agua y beba abundante agua.



COD-KXO2
 CHEMICAL OXYGEN DEMAND : KEMIX DD2

147.8 g / l

Químicos

- Mantenimiento Industrial
- Tratamiento de aguas
- Sanitización
- Institucional

Servicios

- Diagnóstico de agua
- Limpieza especializada
- Certificación
- Sanitización de áreas

SANITIZANTE VIRICIDA PARA MANOS Y CUERPO

RETO BIOCIDA

NOMBRE Y CLAVE DEL PRODUCTO- SANITIZANTE GERMICIDA - CORPORAL Y SUPERFICIES - SANIVIR - SVA

USOS: SANIVIR es un producto sanitizante con muy amplio espectro de sales cuaternarias de última generación (DIDECYL DIMETHYL AMMONIUM CHLORIDE, BENZALKONIUM CHLORIDE).

RETO BACTERIANO	
10 minutos tiempo de contacto	
Enterobacter aerogenes	
Pseudomonas aeruginosa	
Salmonella choleraesuis	
Shigella dysenteriae	
Staphylococcus aureus	
5 minutos tiempo de contacto	
Enterococcus faecium	
Enterococcus faecium (Antibiotic Resistant)	
Enterococcus faecium (Vancomycin Resistant)	
Escherichia coli	
Escherichia coli O157:H7	
Escherichia coli (Antibiotic Resistant)	
Klebsiella pneumoniae	
Klebsiella pneumoniae (Antibiotic Resistant)	
Listeria monocytogenes	
Proteus mirabilis (Clinical Isolate)	
Proteus vulgaris	
Salmonella choleraesuis (ssp enteritidis)	
Salmonella choleraesuis (ssp pullorum)	
Salmonella typhi	
Salmonella typhimurium	
Serratia marcescens (Industry Isolate)	
Shigella flexneri	
Shigella sonnei	
Staphylococcus aureus (Methicillin resistant) (MRSA)	
Staphylococcus epidermidis	
Staphylococcus epidermidis (Antibiotic Resistant)	
Streptococcus pneumoniae (Oxacillin Resistant)	
Streptococcus pyogenes	
Yersinia enterocolitica	

RETO VIRAL	
5 minutos tiempo de contacto	
Bovine Viral Diarrhea (BVDV)	
Herpes simplex Type I	
Herpes simplex Type II	
Influenza A2/Hong Kong	
Pseudorabies virus	
Respiratory Syncytial Virus	
Coronavirus	
Vaccinia Virus	
3 minutos tiempo de contacto	
Hepatitis B Virus (HBV)	
30 segundos tiempo de contacto	
HIV-1 Strain HTLV-III	
RETO FUNGI (Hongos y esporas)	
5 minutos tiempo de contacto	
Candida albicans	
10 minutos tiempo de contacto	
Trichophyton mentagrophytes	
Aspergillus flavus	

*Pruebas a 400 PPM de dureza del agua y 5% de carga contaminada 5ml/lt




Mantenimiento Preventivo

El mantenimiento aquí indicado no cancela la garantía del equipo, se deberá seguir con los cuidados propios de la manipulación de equipos eléctricos y/o electrónicos.

Este mantenimiento se deberá realizar al menos una vez al mes, dependiendo del uso que se le de al equipo:

1

Desconecte el equipo de la fuente eléctrica y/o retire las baterías.

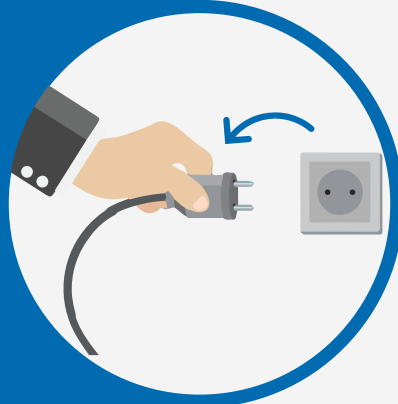


Vacíe el tanque de gel.

2

3

Agregue entre 150 y 250 ml de alcohol líquido y enjuague el tanque brevemente.



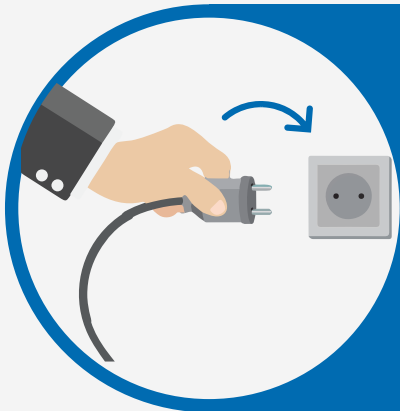


Sin vaciar el alcohol, conecte y haga funcionar el equipo hasta vaciar el alcohol del tanque. De ser necesario repita el paso 3 y 4.

4

5

Con un paño suave e impregnado ligeramente con alcohol, limpie los residuos de gel de la boquilla dispensadora.

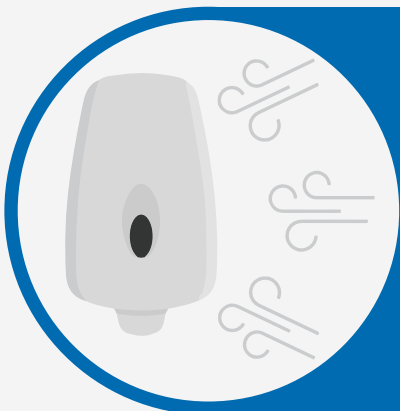

En caso de haber presentado salpicaduras o escurrimientos deje secar por unos minutos.

6

7

Llene nuevamente de gel.



Si los equipos permanecen inactivos por un largo periodo de tiempo, se recomienda vaciar el tanque para evitar que el gel se seque y tape los conductos.